Metoda Z040 – pH 6.0-8.5

Specyfikacja

Opis:	Test do pomiaru pH w wodzie słodkiej
Zakres:	6.0 – 8,5 pH
Rozdzielczość:	0,05 pH
Długość fali:	520 nm

Zestaw odczynników

Nr katalogowy	Opis	Skład zestawu
8040	Zestaw odczynników do metody Z040, pH 6.0-8.5 (odczynniki dla około 40 testów)	✓ Odczynnik pH 6.0-8.5 ✓ strzykawka 1 ml

Wykonanie pomiaru

1. Wybierz metodę Z040 pH 6-8.5 (**Metody → Wybierz metodę → Z040 pH 6.0-8.5**).

   UWAGA:.
   Skorzystaj z opcji Przewodnika - wygodnego systemu podpowiedzi, który prowadzi przez kolejne etapy procedury oraz odlicza i sygnalizuje koniec reakcji tam gdzie to konieczne. Aby skorzystać z tej funkcji wciśnij klawisz kontekstowy GUIDE.

2. Trzykrotnie przepłucz fiolkę i strzykawkę badaną wodą.
   Pobierz strzykawką dokładnie 5 ml badanej wody i przelej do fiolki.
   UWAGA:
   Należy upewnić się czy w strzykawce nie ma pęcherzyków powietrza. Ich obecność może obniżyć wiarygodność wyników pomiaru.

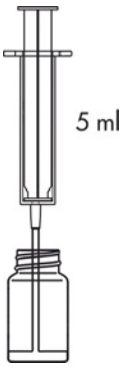

3. Włóż fiolkę do gniazda pomiarowego i naciśnij przycisk **ZERO**. Na wyświetlaczu pojawi się **"-0.0-"**, co oznacza, że urządzenie jest gotowe do wykonania pomiaru.



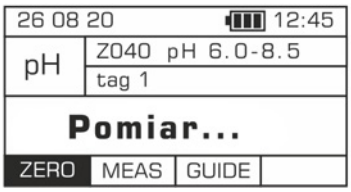

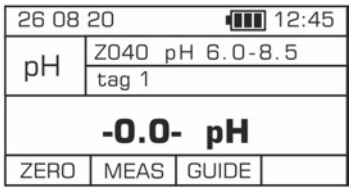

UWAGA:
Przed przystąpieniem do pomiaru należy się upewnić czy zewnętrzne ścianki fiolki są czyste i suche. Pozostałości cieczy na fiolce mogą obniżyć dokładność pomiaru.

4. Dodaj 0.5 ml **Odczynnika pH 6.0-8.5** i potrząsaj fiolką, aż do uzyskania jednolitej barwy.

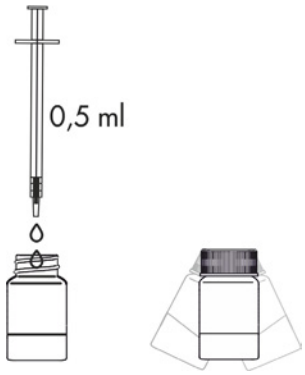
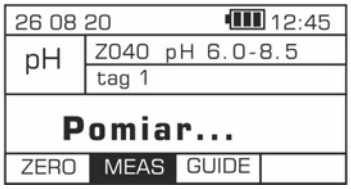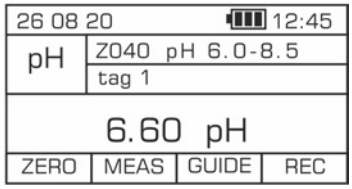
5. Włóż fiolkę do gniazda pomiarowego i naciśnij przycisk **MEAS** aby wykonać pomiar. Wynik zostanie wyświetlony w jednostkach pH.